



バイアル用ミニ遠心機

NTCF-V8

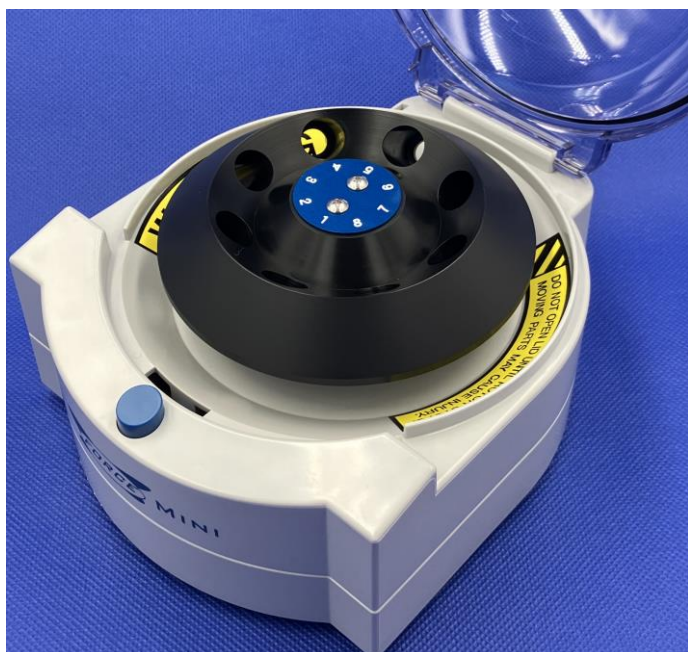

バイアル用の専用遠心機です。
バイアルは8本掛けになります。

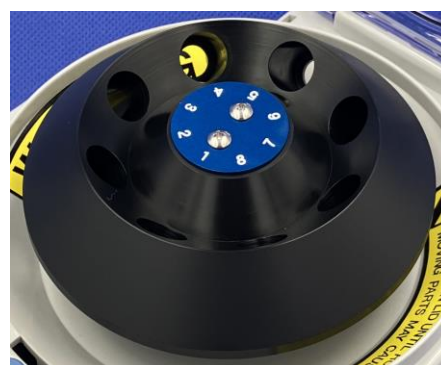

撹拌



遠心後

上記テストは食用粉体で行いました。(平均粒度: 30~40 μ m)
回転時から停止までの時間は約6秒です。

希望小売価格 ￥108,000—

Contributing to the Society Through Support to the Advanced Research

 **日京テクノス株式会社**

17-8 Hongo, 2-Chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 Japan

Tel 03-3814-2066 Fax 03-3814-2060

<http://www.nikko-tec.co.jp>